



Inhoudsopgave

Qu'est-ce qu'un coffret ProCase?

Description générale

Pour votre sécurité

Conventions

Défauts

Important

Garantie

Présentation du produit

Le coffret ProCase comprend les éléments

suivants Installation

Important

Montage sur la brique ou le

béton Câble d'alimentation

Montage sur bois

Montage du coffret ProCase

Utilisation

En cas d'urgence (utilisation DEA)

Entretien et dépannage

Entretien

Température

Modification du code (SC1320/ 1340/1435)

Remplacement du verre de sécurité

Dépannage

Lexique

41

41

41

42

43

Qu'est-ce qu'un coffret ProCase?

Le DEA (défibrillateur externe automatisé) est un dispositif important en cas d'arrêt cardiaque. Il est d'une importance vitale que le DEA soit protégé, sécurisé et disponible 24h/7j pour une assistance immédiate en cas d'urgence. Notre coffret ProCase donne une protection optimale et permet une disponibilité du DEA nuit et jour. Le coffret extérieur ProCase est conçu pour protéger le DEA contre les conditions climatiques extrêmes. Le coffret résiste à l'eau, à la violence et possède un design moderne. L'aluminium est découpé par laser et soudé par robotisation. Une fenêtre en polycarbonate donne une vue claire du DEA. Deux amortisseurs hydrauliques font descendre la partie inférieure de la console DEA après actionnement de la serrure. Pour maintenir une température au-dessus de 0°C, le coffret ProCase extérieur est équipé d'un capteur de température et d'un élément chauffant. La serrure du coffret ProCase est solide.

Description générale

Reportez-vous à la page 1 et 2



1. Unité de commande (avec lumière, alarme sonore, ventilateur et code tactile) (Seulement SC1435, SC1320, SC1340)
2. Consignes de sécurité
3. Bouton rouge
4. Rotor de verrouillage du système de fermeture (à droite)
5. Support de DEA (avec chauffage SC1330, SC1340, SC1415, SC1420, SC1435)
6. Tige de fermeture
7. Lumière LED
8. Câble d'alimentation



Pour votre sécurité

Conventions

Lire attentivement le manuel. Tous les utilisateurs doivent prendre connaissance des consignes de sécurité avant de mettre le coffret SixCase en service. Suivez les instructions pour éviter tout danger et être dans la légalité ainsi que les instructions d'entretien recommandées. Si un problème survient, consultez le fabricant dès que possible. Ne pas utiliser l'appareil jusqu'à ce qu'il ait été inspecté par un personnel compétent.

		Symbole
Avertissement:	Les avertissements vous informent des situations ou actions qui peuvent entraîner des blessures ou la mort.	
Attention:	Les mises en garde vous signalent les conditions ou les actions qui peuvent causer des dommages à l'unité.	

Défauts

Tous les appareils sans fil peuvent être sensibles et provoquer des interférences. Cela peut influencer le fonctionnement de l'appareil. Utiliser et fixer des produits compatibles qui sont certifiés par SixCase.com.

Important

GT Medicare n'est en aucun cas responsable de l'installation et de l'utilisation du coffret ou de la perte de données ou de dommage direct ou indirect causé à des tiers ou en cas de conditions extérieures exceptionnelles, comme des basses températures, des pièces défectueuses ou d'autres éléments externes pouvant rendre inutilisable le DEA.

GT Medicare se réserve le droit d'adapter et d'améliorer ce document et tous les produits liés à ce mode

d'emploi, sans notification préalable. Le contenu de ce document est fourni sans aucune forme de garantie.

Garantie

- GT Medicare est responsable de la qualité des services et de la solidité et de la bonne qualité des produits fournis dans la limite de ses possibilités, à la condition que la garantie ne dépasse pas les dispositions ci-après mentionnés.
- Si les défauts sont causés par l'acheteur, les réparations et frais d'expédition seront facturés à l'acheteur.
- L'acheteur n'a pas le droit à la garantie :
 - A: En cas de négligence du coffret par l'acheteur
 - B: Si l'acheteur a apporté des modifications au produit en cas de réparations qui n'ont pas été effectuées par ou au nom de GT Medicare.
 - C: Dans le cas d'une utilisation inappropriée ou négligente, une connexion incorrecte, mauvaise tension, la foudre, les dommages dus à l'humidité ou d'autres produits.
 - D: Si le coffret n'a pas été utilisé de façon correcte ou suivant le manuel d'utilisation.
 - E: Si l'appareil est utilisé avec des accessoires défectueux.
 - F: Si l'acheteur utilise le produit avec négligence.
- La société GT Medicare garantit que les produits ne contiennent pas de défauts graves au moment de la livraison.
- L'acheteur doit signaler les défauts, les dommages ou la non-conformité des produits, qui lors d'une inspection peuvent être raisonnablement déterminés, par écrit à GT Medicare dans les 10 jours après réception. L'acheteur doit signaler tous les autres défauts par écrit à GT Medicare dans un délai d'un an à partir de la date de livraison. Les



pièces qui semblent non conformes ou endommagées, doivent être retournées pour inspection à GT Medicare. Les réclamations qui n'ont pas été déclarées selon les termes de ce paragraphe, ne seront pas acceptées. GT Medicare, en cas de responsabilité pour la non-conformité ou de détérioration du produit, a le choix de réparer les produits, de les remplacer par des neufs ou de rembourser le prix d'achat des produits. GT Medicare n'aura pas d'autre obligation ou responsabilité à l'égard de l'acheteur en matière de non-conformité ou produits endommagés autres que dans le paragraphe ci-dessus.

6. La durée de la garantie sur toutes les pièces mécaniques est de 24 mois pour les coffrets de SC1300, les égratignures et les dommages extérieurs subits par le coffret et la fenêtre n'entrent pas dans cette disposition, et de 24 mois pour les appareils électroniques à partir du moment de la livraison. Le producteur est obligé uniquement de remplir les obligations découlant de la présente garantie. Le producteur n'est pas responsable des dommages indirects ou les conséquences de ceux-ci. Dans tous les cas, la responsabilité du fabricant est limitée au prix de vente des produits vendus.
7. Si une réclamation peut être attribuée à une modification ou une mauvaise utilisation du produit par l'acheteur décrit dans le contrat la garantie, celle-ci est dans tous les cas sans vigueur.
8. L'acheteur doit vérifier immédiatement tous les équipements reçus. Le client doit informer GT Medicare par écrit, dans les dix (10) jours suivant la réception, de tous les défauts de l'envoi. Si les irrégularités ne sont pas signalées dans un délai de dix (10) jours, l'envoi a été considéré comme approuvé. Si une réclamation est acceptée par Procamed est seulement

obligé de remplacer ou réparer les pièces défectueuses, le client ne peut pas prétendre à une quelconque indemnisation. La présentation d'une demande ne dispense pas le client de paiement.

Présentation du produit

Merci d'avoir acheter ProCase.

Le coffret ProCase comprend les éléments suivants

- Coffret ProCase
- Clef (facultatif)
- Adaptateur 24V (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435)
- Alimentation 3m de câble (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435)
- Notice d'installation
- Chauffage (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435)
- Module GSM (SMS info pack)
- Cheville (4x)
- M8 vis de merrains (4x)
- Rondelles (4x)
- Entretoises (4x)
- M8 Boulons (4x)

Installation

Important

Les outils d'installation livrés sont destinés à monter le coffret exclusivement sur des surfaces planes en bois, brique ou béton. Les panneaux doivent avoir une épaisseur minimum de 3 mm. Toujours utiliser les entretoises fournies.

Montage sur la brique ou le béton

Placez le gabarit fourni contre le mur et marquer les trous. Percez des trous de 10 mm de diamètre à une profondeur minimale de 60 mm, pour être sûr qu'ils soient suffisamment profonds pour la fiche.



Nous vous recommandons de percer les trous supérieurs entre 1,5 et 1,6 mètres du sol. Les trous doivent être percés toujours au milieu de la brique.

Câble d'alimentation

Procamed recommande également de percer le trou de 12 mm de manière à ce que le câble d'alimentation puisse être dirigé à travers la paroi. Il peut alors être fixé à l'adaptateur 24 V, qui doit être placé à l'intérieur de la maison ou du bâtiment. Il est important de faire passer le câble d'alimentation à travers la paroi avant de monter le coffret sur ce mur.

Le câble comporte un connecteur qui lui permet d'être attaché au coffret SixCase. Introduire le câble de l'extérieur à travers la paroi à l'intérieur, puis, à partir de l'intérieur, tirer le câble jusqu'à ce que le connecteur touche le mur. Le fil métrique peut être conduit à travers le trou et le coffret est alors prêt à être monté sur le mur. Après le montage, en utilisant les quatre écrous, le connecteur peut également être attaché avec une épave en plastique.

Attention

Si le mur n'est pas très solide, nous recommandons d'utiliser Fischer VS 100P. Après la pulvérisation du liquide dans les trous, insérez uniquement les vis – dans ce cas, ne pas utiliser de chevilles. Lisez attentivement les instructions sur l'étiquette Fischer et assurez-vous de nettoyer les trous à fond après le forage.

Montage sur bois

Percez de petits trous d'environ 4 mm de diamètre dans le bois et, à l'aide d'un outil, vissez l'écoute électronique fermement dans le bois, puis monter le coffret comme indiqué ci-dessus. Les vis ne doivent pas dépasser de plus de 30 mm de la surface en bois. Verrouillez le coffret à nouveau avec les quatre vis. Nous vous recommandons de percer les trous supérieurs à une hauteur comprise entre 1,5 et 1,6 m du sol.

Montage du coffret SixCase

Fixer le coffret sur les fils de dérivation que vous

venez d'installer dans le mur et bloquer avec les quatre écrous de l'intérieur du coffret. Les écrous peuvent être serrés avec une clé à fourche n° 13. Veillez à ne pas coincer le câble d'alimentation.

Clef

La clef vous permettra d'ouvrir le coffret sans casser le verre ou l'activation du système de verrouillage en option. Elle vous permettra d'avoir toujours accès au défibrillateur en cas d'urgence ou pour des raisons de maintenance. Pour ouvrir le coffret SixCase, tournez la clé vers la gauche et appuyez simplement sur le cylindre noir à l'intérieur du bouton rouge.

Utilisation

Pour fermer le coffret, placez les deux mains sur les côtés gauche et droit du coffret et pousser vers le haut. Les deux serrures (gauche et droite) produiront ensuite un dé clic pour confirmer que le coffret est correctement verrouillé des deux côtés.



En cas d'urgence (utilisation DEA)

SC1310/ 1330: Appuyez sur le bouton rouge (comme indiqué sur l'étiquette d'instruction), attendre jusqu'à ce que le support ait atteint sa position la plus basse et enlever le DEA.
 SC1415: Insérer la clé sur la droite du support de DAE (comme indiqué sur l'étiquette d'instruction) et tourner la puissamment vers la droite. Attendre jusqu'à ce que le support ait atteint sa position la plus basse et enlever le DEA.
 SC1420: Appuyez sur le bouton rouge (comme indiqué sur l'étiquette d'instruction), attendre jusqu'à ce que le support ait atteint sa position la plus basse et enlever le DEA.
 SC1320/ 1340/ 1435: Entrez le code programmé (ou insérer la clé sur la droite et tourner la clé puissamment vers la droite), attendre jusqu'à ce que le support ait atteint sa position la plus basse et enlever le DEA (à la fois le



code et la clé doivent être disponibles en cas d'urgence).



Important

En raison d'un défaut inattendu, il se peut que l'une des procédures d'ouverture échoue. Dans ce cas, il est nécessaire d'avoir une alternative disponible. En outre, il est important de répéter les procédures mentionnées ci-dessus avant de ranger le défibrillateur, et souvent après avoir installé le DEA pour vérification.

Entretien et dépannage



Entretien

Il est essentiel d'ouvrir et de fermer le coffret SixCase de façon hebdomadaire afin de vérifier que les systèmes de verrouillage et tous les composants électroniques fonctionnent correctement. Ce faisant, vous devez prendre note du bon fonctionnement du bouton-poussoir, clavier à code, serrure à clé, la serrure de verrouillage du rotor et éventuellement l'état du défibrillateur (il est conseillé de vérifier manuellement le DEA). Ensuite, appuyez fermement sur le bouton rouge, en insérant la clé ou la saisie du code, la partie inférieure de l'armoire doit progressivement se déplacer vers le bas sans aucune obstruction, permettant ainsi l'accès au défibrillateur. Il est également important de vérifier l'état extérieur du coffret de tout dommage, qui peut éventuellement affecter son fonctionnement. Si le coffret dispose d'un système de verrouillage électrique, le moteur sera vérifié une fois par jour automatiquement. En cas de présence de courants externes, il est nécessaire de les décharger en plaçant le coffret à terre. Lors de la découverte d'un défaut, contactez votre revendeur ou directement GT Medicare. Selon le type de défaut, il peut être conseillé de retirer le DEA et d'informer les utilisateurs sur le statut inutilisable.

Température

Si vous avez un doute sur le fonctionnement de l'appareil de chauffage (température extérieure inférieure à 0°C (32°F)), éteignez le défibrillateur et contactez votre revendeur.

Le SC1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435 sont équipés d'un système de ventilation actif. Autour 30°C le ventilateur se met en marche pour libérer la chaleur de la partie supérieure et la succion de l'air froid par le bas. Néanmoins, nous vous recommandons d'installer le coffret à l'ombre pour éviter des températures élevées (au-dessus 50°C).

Modification du code (SC1320/ 1340/1435)

Le code par défaut pour accéder à la SixCase est le: 1234 Ouvrez le coffret SixCase en utilisant le code clé ou par défaut (1234).

Entrez le code 1245 afin de modifier le code, l'alarme s'arrête.

Entrez le nouveau code et confirmer le avec le V vert, l'alarme se déclenche à nouveau.


Votre code a été changé.

Remarque: Toujours vérifier que la modification du code en ouvrant le coffret SixCase a été effectuée en utilisant le nouveau code.

Remplacement du verre de sécurité

Avant de remplacer le verre de sécurité, fermer le coffret. S'assurer que l'ancien verre soit enlevé pour ne pas entraver le fonctionnement de la serrure.

Tirer le bouton rouge vers vous et installez le verre de sécurité. Puis remettre le bouton rouge à sa position initiale, de sorte que le verre ne se brise pas.

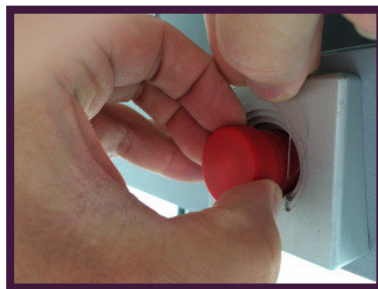

Depannage

Défaut	Action
Lumières éteints	Vérifiez l'alimentation externe (alimentation et adaptateur) Vérifier les câbles de mesure de la puissance dans le coffret (12 ou 24 Volts) Si l'opération continue d'échouer, mettre sur hors service et retirer l'unité de contrôle puis contacter votre détaillant ou GT Medicare.
Si le code tactile ne réagit pas à l'entrée	Vérifiez l'alimentation externe (alimentation et adaptateur) Vérifier les câbles de mesure de la puissance dans le coffret (12 ou 24 Volts) Si l'opération continue d'échouer, mettre sur hors service et retirer l'unité de contrôle puis contacter votre détaillant ou GT Medicare.
Le coffret ne se ferme pas correctement	Coffret ouvert manuellement ou par code Placez les deux mains sur le bas à gauche et à droite sur les côtés du coffret et pousser vers le haut Les dispositifs de verrouillage (gauche et droite) doivent produire un déclic pour confirmer que le coffret est correctement verrouillé des deux côtés. Si l'opération continue d'échouer, mettre sur hors service et retirer l'unité de contrôle puis contacter votre détaillant ou GT Medicare.
Le coffret ne s'ouvre pas sur les deux côtés (SC1310/1330/ 1420)	Fermer le coffret à nouveau Utilisez plus de force en appuyant sur le bouton rouge Si l'opération continue d'échouer, éteindre l'appareil et contacter votre détaillant ou GT Medicare.
Le code tactile réagit mais le coffret ne s'ouvre pas sur les deux côtés (SC1320/ 1340/ 1435)	Appliquer une force modérée sur le support inférieur, si le coffret s'ouvre, recommencez la procédure normale Si le coffret ne s'ouvre pas, le système de verrouillage est défectueux ou une pièce est manquante, l'éteindre et contactez votre détaillant ou GT Medicare.



Si le bouton-poussoir rouge ne fonctionne pas et que le coffret ne s'ouvre pas (SC1310/ 1330/ 1420/ 1710)

Appliquez une force modérée sur le support inférieur, si le coffret s'ouvre, recommencez la procédure normale

Si le coffret ne s'ouvre pas, le système de verrouillage est défectueux ou une pièce est manquante, l'éteindre et contacter votre détaillant ou GT Medicare.

Lexique

DEA

Le DEA (défibrillateur externe automatisé) est un dispositif important en cas d'arrêt cardiaque. Il est essentiel que le

DEA soit protégé, sécurisé et disponible 24h/24 7j/7 pour une assistance immédiate dans une situation d'urgence.

Opérateur / utilisateur

La personne responsable du coffret doit vérifier l'état du DEA et de s'assurer du fonctionnement conforme aux directives de la manière décrite dans ce manuel.

GSM

Global System for Mobile communications.

SMS

Short Message Service

Service en ligne

Pour plus d'informations ou de l'aide en ligne, veuillez visiter notre site web www.sixcase.com.

Mode d'emploi: Le manuel contient toutes les informations nécessaires sur le fonctionnement du coffret SixCase.

Les mises à jour sont publiées sur notre site web.

comme des basses températures, des pièces défectueuses ou d'autres éléments externes pouvant rendre inutilisable le DEA. GT Medicare se réserve le droit d'adapter et d'améliorer ce document et tous les produits liés à ce mode d'emploi, sans notification préalable. Le contenu de ce document est fourni sans aucune forme de garantie.




Avertissement

Procamed n'est en aucun cas responsable de l'installation et de l'utilisation du coffret ou de la perte de données ou de dommage direct ou indirect causé à des tiers ou en cas de conditions extérieures exceptionnelles,

ProCase

Montageanleitung

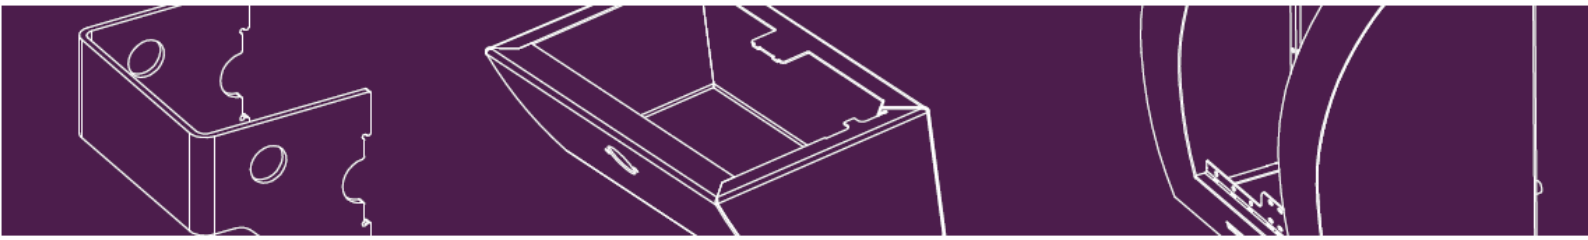


Übersicht:

Warenmarke/Urheberrecht	1
Was ist ProCase?	2
Für Ihre Sicherheit	2
Störung.....	2
Zubehör.....	2
Wichtig.....	2
Einführung ProCase	3
Was ist in dem Paket.....	3
Garantie.....	3
Montageanleitung	4
Montage auf Stein oder Beton.....	4
Montage auf Holz.....	5
Wartung	6
Wichtig.....	6
Problembehandlung	7

ProCase

Montageanleitung

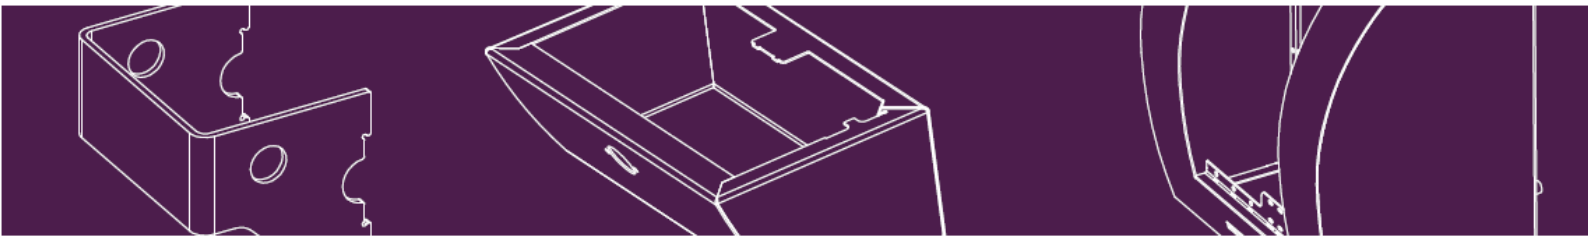

Was ist ProCase?

Der AED (Automatisierter Externer Defibrillator) macht inzwischen einen wichtigen Teil der primären Hilfe aus. Es ist dabei lebenswichtig, dass der AED Tag und Nacht gut gesichert, aber doch erreichbar ist.

Der ProCase gibt eine optimale Beschirmung/Sicherheit und sorgt für einen Tag und Nacht einsetzbaren AED.

Der einmalige Entwurf für dieses Gehäuse bietet guten Schutz für den AED und ist beständig gegen Nässe. Um auch extremen Witterungseinflüssen zu widerstehen ist der ProCase mit einem Temperaturfühler und Heizelement ausgerüstet, um eine optimale Temperatur für den AED zu gewährleisten.

Für Ihre Sicherheit

Lesen Sie das Instruktionbuch sorgfältig durch. Das Nichtbefolgen der Instruktionen kann gefährlich sein, oder selbst gegen Gesetze verstoßen. Lesen Sie die vollständige Gebrauchsanweisung für mehr Informationen.


Störung: alle drahtlosen Apparaturen können anfällig sein für Störungen. Dadurch kann die Wirkung des Apparates negativ beeinflusst werden.

Zubehör: verwenden Sie nur durch uns akzeptiertes Zubehör, schließen Sie keine nicht kompatiblen Produkte an.

Wichtig: Der Händler ist nicht verantwortlich für den Inhalt von Dokumenten, noch für den Verlust von Informationen, Einkommen, direktem oder indirektem Schaden, durch die dann verursacht. ProCase behält sich das Recht vor um Dokumente anzupassen oder zu verbessern, ohne vorherige Bekanntmachung. Der Inhalt dieses Dokumentes sowie auch für das Zubehör zu diesem Produkt wird ohne Garantie veröffentlicht.

ProCase

Montageanleitung

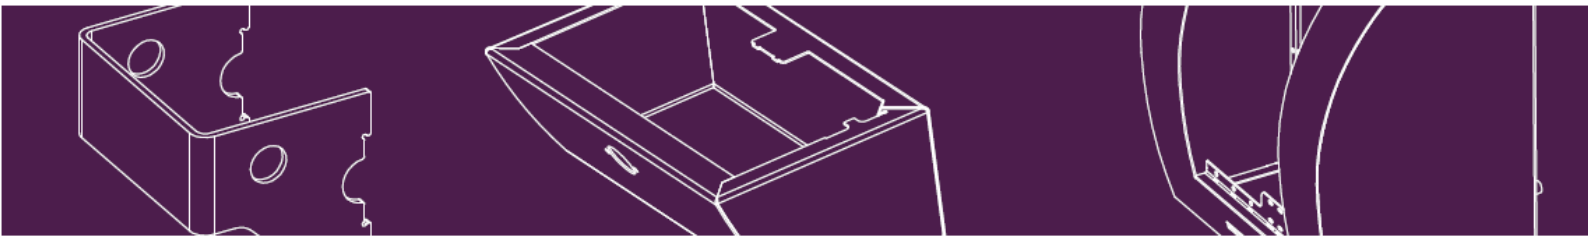

Einführung ProCase

Wir danken Ihnen für den Kauf eines ProCase AED Wandgehäuses.

Inhalt des Paketes: der ProCase enthält die folgenden Unterteile

- **ProCase AED Wandgehäuse**
- **24V Adapter**
- **Stromkabel**
- **Heizung**
- **Mutter** (Gewinde pg7)
- **Wanddübel (4x SX 10x50mm)**
- **Schrauben-/Gewindestangen (4x M8 x 100mm)**
- **Abstandshalter (4x diam. 15x25mm)**
- **Unterlegscheiben (4x diam. 8 x 2mm)**
- **Muttern (4x M8x5mm)**
- **Montageanleitung**


*Zahlen in fett gedruckt geben die Anzahl wieder

Garantie

Der Kunde verliert seinen Garantieanspruch bei folgendem:

- A: wenn der Defekt durch den Kunden verursacht wurde
- B: bei fahrlässigem Umgang mit dem Produkt
- C: bei vorgenommenen Änderungen am Produkt welche nicht mit dem Händler abgesprochen wurden
- E: bei fahrlässigem Gebrauch, falschem Anschluss, falscher Spannung, einwirken anderer Produkte
- F: bei unangemessener Wartung
- G: bei Verwendung von falschem Zubehör

Der Händler garantiert die Funktionalität der Produkte bei Auslieferung.

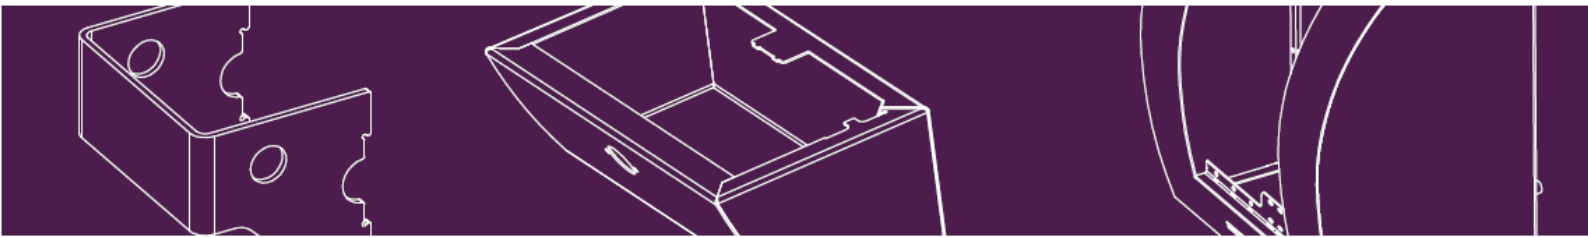

Montageanleitung

Wichtig: die korrekte Ausführung der Installation ist extrem wichtig und fällt außerhalb der Verantwortlichkeit von ProCase. Das mitgelieferte Material ist nur gedacht für Montagen an massivem Holz, Stein, Beton oder an metallenen Platten mit einer minimalen Stärke von 3mm.



Montage auf Stein oder Beton: positionieren Sie die beige-lieferte Schablone (A4 Format) auf die Mauer und zeichnen Sie die Bohrungen ab. Bohren Sie Löcher mit einem Durchmesser von 10mm und einer minimalen Tiefe von 60mm um genug Raum zu haben für die Wanddübel oder evtl. chemischen Mörtel. **Empfehlung:** die obersten Bohrungen ungefähr in **1,5m** Höhe zu platzieren. Die Bohrungen müssen immer in der Mitte des Steines ausgeführt werden.

Montage Tipp: mit einem Inbusschlüssel kann der Gewindestift mit der richtigen Vorspannung in die Mauer geschraubt werden. Der Stift muss bis zum metrischen Gewinde M8 eingeschraubt werden.

Stromkabel: Der Hersteller empfiehlt, die mittlere Bohrung mit einem 12mm Bohrer auszuführen, damit das Stromkabel ohne Probleme durch die Mauer geführt werden kann. Das Stromkabel kann mittels einer Steckverbindung an den Adapter angeschlossen werden. Diese Steckverbindung kann durch die 12mm Bohrung geführt werden, da der Adapter innerhalb von Gebäuden platziert werden muss.


Bevor der ProCase befestigt wird ist darauf zu achten, das Stromkabel durch die Mauer zu führen. Führen Sie das Kabel von außen durch die Mauer, bis das Klemmfutter gegen die Mauer kommt. Danach kann der ProCase aufgehängt und das Stromkabel durch das mittlere Loch geführt werden.

Drehen Sie von innen die Kunststoffmuttern fest und klicken Sie die Steckverbindung oben in die Modulplatte. Damit ist der ProCase angeschlossen.

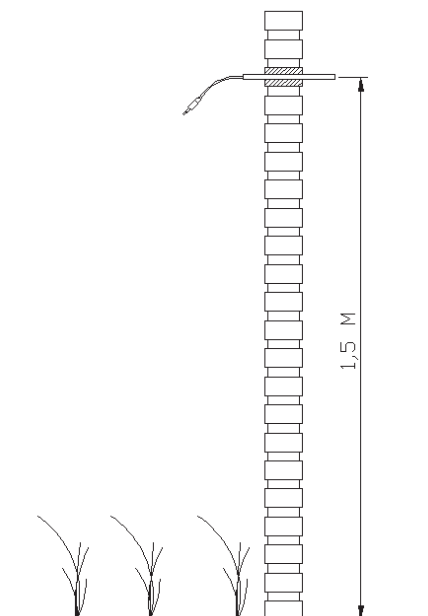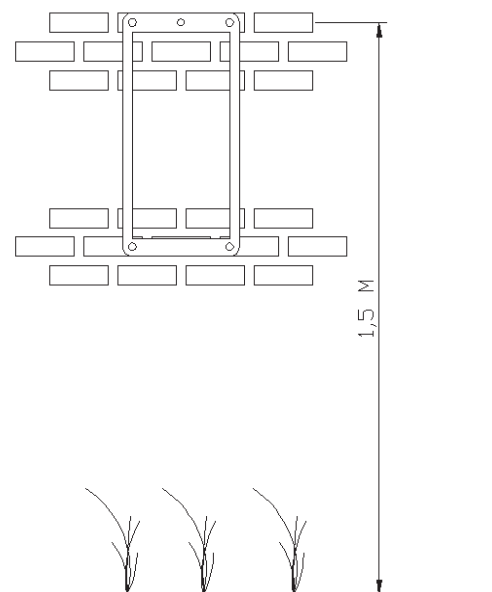

ProCase

Montageanleitung

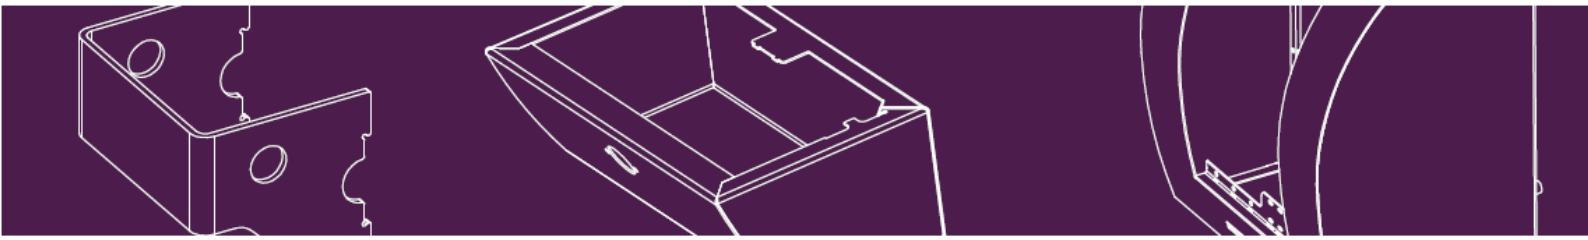

Montage

Bitte beachten: wenn sich herausstellt, dass die Mauer zu schwach ist um den ProCase mit Dübeln zu befestigen, empfehlen wir Fischer VS 100 P. Es ist dann ausreichend um nur die Schrauben ohne Dübel in den Mörtel zu schrauben. Auf der Verpackung von Fischer VS 100 P steht die korrekte Gebrauchsanweisung. Beachten Sie, dass die Bohrungen gut gereinigt werden (1x ausblasen, 1x ausbürsten, 1x ausblasen, 1x ausbürsten) bevor Sie den Dübel oder den chemischen Mörtel in die Bohrung einbringen.

Montage auf Holz

Bohren Sie an Hand der mitgelieferten Schablone kleine Löcher von 4mm Durchmesser in das Holz. Schrauben Sie die Gewindeschrauben so weit in das Holz, bis das M8 Gewinde noch maximal 35mm herausragt. Wir empfehlen die obersten Bohrungen ungefähr in 1,5m Höhe zu platzieren. Auf dem Ende der Gewindestange kann ein Inbusschlüssel aufgesetzt werden, um die Schraube mit der richtigen Vorspannung in das Holz zu drehen.


Aufhängen des ProCase

Hängen Sie das Gehäuse an die Gewindestangen, welche sie im Holz oder in der Mauer verankert haben. Befestigen Sie von der Innenseite aus den ProCase mittels der mitgelieferten M8 Muttern und den Unterlagscheiben. Drehen Sie mit einem Schraubenschlüssel 13 die Muttern fest an (nicht überdrehen).

Beachten! Sorgen Sie dafür, dass das Adapterkabel nicht eingeklemmt wird.

ProCase

Montageanleitung

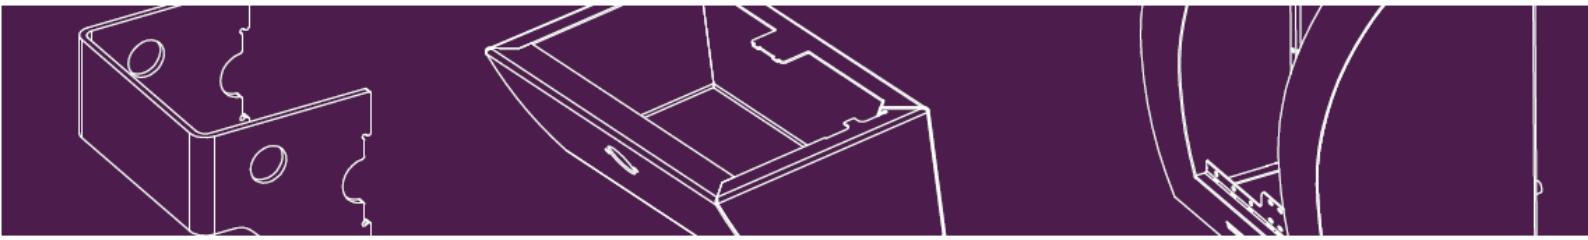

Wartung

Es ist wichtig 4x jährlich das Öffnen und Schließen des Gehäuses zu kontrollieren.



Wartung

Es ist ebenso wichtig, das Gehäuse auf Beschädigungen zu überprüfen, die dessen Funktion möglicherweise beeinträchtigen könnten.




Wichtig

Um ein gutes Funktionieren des ProCase zu garantieren darf nur das durch den Händler mitgelieferte Zubehör verwendet werden.

Temperatur

Wenn Sie Zweifel an der Funktion der Heizapparatur haben (Außentemperatur unter 0° C), entfernen Sie den Defibrillator und nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Händler auf.

Der ProCase SC1330 ist mit einem aktiven Belüftungssystem ausgestattet. Bei ungefähr 30° C wird der Ventilator eingeschaltet, um die Wärme aus dem oberen Teil abzuführen. **Dennoch empfehlen wir, das Gehäuse an einem schattigen Ort aufzuhängen, um zu hohe Temperaturen zu vermeiden (über 50 °C).**

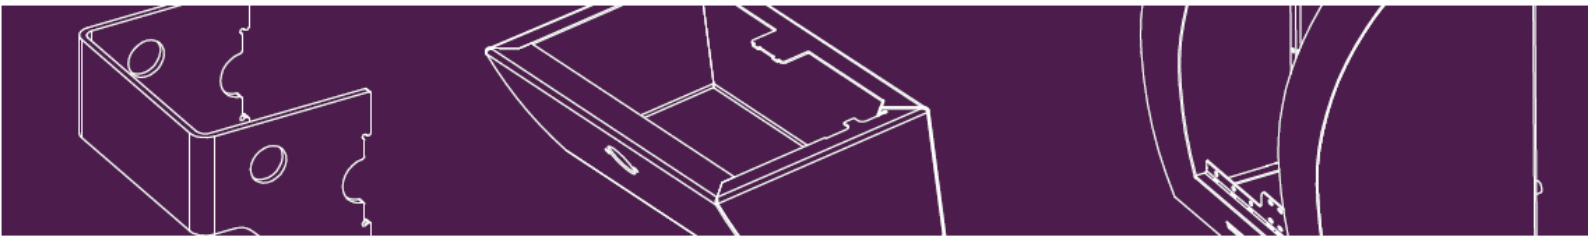

Problembehandlung

LED aus:

Prüfen Sie die externe Stromversorgung (Stromversorgung und Adapter). Kontrollieren Sie die Kabel, indem Sie die Spannung am Modulanschluss im Kasteninneren messen (24V). Wenn das Gerät nicht funktioniert, nehmen Sie es außer Betrieb und kontaktieren Sie Ihren Händler.

Gehäuse schliesst nicht korrekt:

Öffnen Sie das Gehäuse. Drücken Sie den Boden des Gehäuses mit beiden Händen links und rechts nach oben. Beide Schlösser (links & rechts) müssen mit einem hörbaren Klick einrasten, um zu bestätigen, dass das Gehäuse auf beiden Seiten geschlossen ist. Wenn das Gerät nicht funktioniert, nehmen Sie es außer Betrieb und kontaktieren Sie Ihren Händler.

Austausch des Bruchsiegels

Bevor Sie das Bruchsiegel austauschen, müssen Sie das Gehäuse schließen. Stellen Sie sicher, dass alle Siegelsplitter aus dem Gehäuse entfernt wurden und die Funktion des Schlosses nicht beeinträchtigen. Ziehen Sie den roten Knopf in Ihre Richtung und setzen Sie das Bruchsiegel ein. Bringen Sie den Knopf anschließend vorsichtig in seine Ausgangsposition zurück, sodass das Glas nicht bricht.

